


Rotating Anode X-Ray Tube
 Tubes Radiogènes à Anode Tournante
 Röntgenröhre mit rotierender Anode
 Tubos de Rayos-X con Ánodo Giratorio



Note: Document originally drafted in the English language.




Product Description	Description du Produit	Produktbeschreibung	Descripcion del Producto
<p>The G-2090BI is a 5.0" (127 mm) 125 kV, 1,428 kJ (2.0 MHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This metal center section insert is designed for radiography, cineradiography, digital and film screen angiography procedures. The insert features a 12° rhenium-tungsten facing on molybdenum with a graphite backed target and is available with the following nominal focal spots:</p>	<p>Le tube G-2090BI, à anode tournante de 127 mm, (5,0 pouces), 125 kV, avec une capacité calorifique maximale de 1,428 kJ (2,0 MUC). Cette section métallique centrale a été conçue pour les procédures radiographiques, cinéradiographiques, angiographiques numérisés et sur film. L'tube est pourvu d'une anode avec pente de 12° en rhénium - tungstène sur une base de molybdène et avec un doublage de graphite. Il est disponible avec les combinaisons foyers suivantes:</p>	<p>Die G-2090BI ist eine 5.0" (127 mm) Doppelfokus Drehanoden-Röntgenröhre, mit einer Anoden Wärmespeicherkapazität von 1,428 kJ (2.0 MHU) und einer max. Spannungsfestigkeit von 125 kV. Diese Einsatz mit metallischem Mittelteil wurde für Radiographie- Röntgenkinematographie-, digitale und Filmangiographieverfahren entwickelt. Der rückseitig graphitbeschichtete Rhenium-Wolfram- und Molybdän Anodenteller besitzt einen Winkel von 12°. Folgende Brennfleck-kombination ist lieferbar:</p>	<p>El G-2090BI es un tubo de ánodo giratorio de 127 mm (5.0"), 125 kV, 1,428 kJ (2.0 MHU). Este tubo de metal en la parte central es diseñado específicamente para radiografía, cineradiográfica, digital, y procedimientos de angiografía con película de pantalla. El blanco emisor es una combinación de renio, tungsteno y molibdeno con grafito en la parte posterior con un rayo central de 12 grados. Disponible con las siguientes combinaciones de marcas focales:</p>
<p>0.3 - 0.6 - 1.0 IEC 60336</p>	<p>0,3 - 0,6 - 1,0 CEI 60336</p>	<p>0.3 - 0.6 - 1.0 IEC 60336</p>	<p>0.3 - 0.6 - 1.0 IEC 60336</p>
<p>Nominal Anode Input Power Small - 14 kW IEC 60613 Intermediate - 45 kW IEC 60613 Large - 82 kW IEC 60613 For the equivalent anode input power of 450 Watts</p>	<p>Puissance anodique nominale de l'anode Petit foyer - 14 kW CEI 60613 Moyen foyer - 45 kW CEI 60613 Grand foyer - 82 kW CEI 60613</p>	<p>Nominale Anodenbezugsleistung Klein - 14 kW IEC 60613 Mitte - 45 kW IEC 60613 Gross - 82 kW IEC 60613</p>	<p>Potencia nominal de entrada del anodo Foco fine - 14 kW IEC 60613 Foco intermedio - 45 kW IEC 60613 Foco grueso - 82 kW IEC 60613</p>
<p>Maximum Anode Cooling Rate: 3,700 W (5,170 HU/sec)</p>	<p>Pour la puissance anodique d'équilibre thermique de 450 Watts</p>	<p>Gilt bei einer Aequivalent - Anodenleistung von 450 Watt</p>	<p>Para una potencia equivalente del anodo de 450 Watts</p>
<p>Maximum continuous anode heat dissipation: 3,700 W (5,170 HU/sec)</p>	<p>Toux maximum de refroidissement de l'anode: 3,700 W (5,170 UC/sec)</p>	<p>Nennleistung der Anode: 3,700 W (5,170 HU/sek)</p>	<p>Medida Maxima del Enfriamiento del Anodo: 3,700 W (5,170 HU/seg)</p>
<p>Reference Axis: Perpendicular to port face.</p>	<p>Description calorifique maximim de l'anode (en continu): 3,700 W (5,170 UC/sec)</p>	<p>Maximale kontinuierliche Wärmeableitung des Anodentellers: 3,700 W (5,170 HU/sek)</p>	<p>Maxima disipación termal continuo del Anodo: 3,700 W (5,170 HU/seg)</p>
<p>Reference Axis: Perpendicular to port face.</p>	<p>Référence axe: Perpendiculaire à la face de sortie.</p>	<p>Referenz Achsen: Senkrecht zum Strahlenaustrittsfenster.</p>	<p>Referencia de axes: Perpendicular a la abertura facial.</p>
<p>G-2090BI models have grid control capability.</p>	<p>Les Modèles G-2090BI ont une fonction de commande de grille.</p>	<p>Modell G-2090BI ist mit einer Fähigkeit Gittersteuerungsfunktion</p>	<p>El modelo G-2090BI tiene capacidad para de rejillas controlar los electrones.</p>
<p>(G-2090BI = Any 2 focal spot combinations.)</p>	<p>(L'G-2090BI = deux plusieurs combinaisons focales.)</p>	<p>(Die G-2090BI = Zwei vercheidedn Brennfleckkombinationen.)</p>	<p>(El G-2090BI = Dos varios combinacion de marcas focales.)</p>
<p>This insert is intended for use in Varex Imaging B-240H housings.</p>	<p>Ce tube est essentiellement destiné à être employé dans les gaines Varex Imaging des séries B-240H.</p>	<p>Die Röntgenröhre ist für den Einbau in die Varex Imaging Strahlerhaube B-240H vorgesehen.</p>	<p>Este tubo es diseñado, para uso en los encajes Varex Imaging de la serie B-240H.</p>

Dimensions are for reference only
 Les dimensions sont pour la référence seulement
 Maße sind als nur Referenz
 Las dimensiones están para la referencia solamente



3 Ø Full Wave

Filament Emission Charts IEC 60613
 Abaques d'Émissions des Filaments CEI 60613
 Heizfadenemissionsdiagramm IEC 60613
 Curvas de Emisión de los Filamentos IEC 60613




- Note: When using these emission curves for trial exposures, refer to the power rating curves shown for maximum kV, tube emission, filament current, exposure time, and target speed.
- Remarque: Lors de l'utilisation de ces abaques pour des expositions d'essai, référez-vous aux courbes maximales de kV, d'émission du filament, de temps d'exposition et de vitesse de rotation.
- Anmerkung: Wenn Sie diese Emissionskurven für Testaufnahmen verwenden, beziehen Sie sich hierbei auf die entsprechenden Nennleistungskurven für max. kV-Werte, Röhrenemission, Heizström, und Anodendrehzahl.
- Nota: Si utiliza estas curvas de emisión para exposiciones de prueba, refiérase a las curvas de gradación de potencia para el máximo de kV, tubo de emisión, corriente en los filamentos, tiempo de exposición, y a las curvas de velocidad del objetivo.

Single Load Ratings IEC 60613
 Abaqués de Charge pour Pose Unique CEI 60613
 Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
 Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

3 Ø Constant Potential


100 Hz

NOMINAL FOCAL SPOT SIZE - 0.3




150 Hz


NOMINAL FOCAL SPOT SIZE - 0.3




NOMINAL FOCAL SPOT SIZE - 0.6




NOMINAL FOCAL SPOT SIZE - 0.6



NOMINAL FOCAL SPOT SIZE - 1.0



NOMINAL FOCAL SPOT SIZE - 1.0



Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613




Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

3 Ø Constant Potential

180 Hz

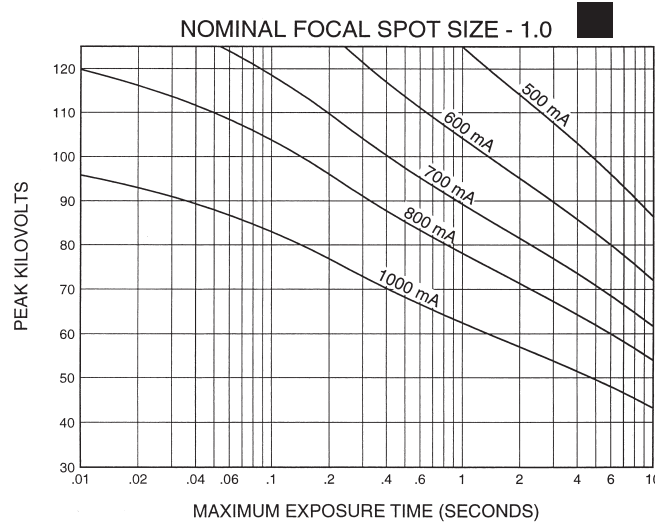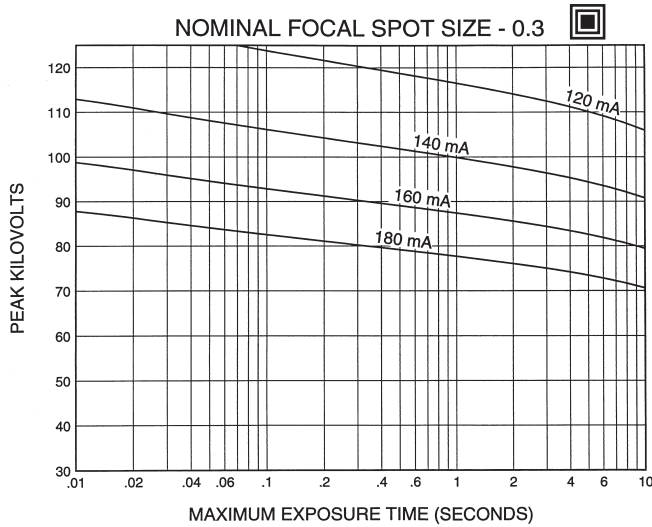

Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

CINERADIOGRAPHIC RATINGS

HOW TO USE CINERADIOGRAPHIC CHARTS

General: With the Cineradiographic rating chart we can determine the maximum allowable kW of the Cine pulse, or with a given kW determine maximum time in seconds the Cine run can progress.

The Most common way of using the charts is to determine maximum time of any expected Cine run and maximum duty factor. With a known duty factor and Cine run time kW can easily be determined.

Definition of Terms

Time in seconds: Total time of one Cine run, usually 5 to 12 seconds.

Duty Factor in Percent (DF%): Actual time during one second the x-ray tube is producing x-rays. If we select a 4 msec pulse width and 60 exposures per second the x-ray tube will be producing x-rays for a total of 240 msec each second or 24% of the time. The higher the DF number, the more load placed on the x-ray tube.

Peak Pulse Power: Peak energy in watts of any one Cine Pulse. Can be any combination of kV and mA allowed by Radiographic and Filament Emission curves.

Example: 80 kV at 400 mA equals

$$\frac{80,000 \text{ V} \times 400 \text{ mA}}{1000} = 32,000 \text{ W or } 32 \text{ kW}$$

USING THE CINE RATING CHARTS:

G-2090 150 Hz 3 Phase 1.0 Focal Spot

Example: Determine maximum kW allowed with the following known factors:

Maximum Pulse Width 4 msec

Exposures per Second60

Maximum Cine Run Time10 seconds

Calculate Duty Factor: (DF%)

$$DF\% = \frac{\text{Pulse Width (mSec)} \times \text{Frames per Second}}{10}$$

$$DF\% = \frac{4 \text{ msec} \times 60 \text{ exp/sec}}{10} = \frac{240}{10} = 24\%$$

Refer to Rating Chart

G-2090 150 Hz 3 Phase 1.0 Focal Spot:

At bottom of chart find 10 second line. Move vertically to intersection with 24% DF curve. Make a horizontal reference to left side of rating chart and note kW rating of 60 kW.

We now know each pulse during the cine run can have a maximum rating of 60 kW under conditions given in example.







kW = kV x mA. The kW of the exposure can be any combination of mA and kW allowed by the Radiographic and Filament Emission Charts.

The Cine rating charts are usable to maximum anode heat content.

3 Ø Constant Potential

100 Hz

150/180 Hz



Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

ANGIOGRAPHIC RATINGS

HOW TO USE ANGIOGRAPHIC CHARTS

General: Serial Radiography puts a severe demand on the x-ray tube due to the large number of exposures made in rapid succession. Intervals between exposures are fixed and so short that it is not possible for the anode track to cool to any extent during the exposure series. Therefore, the temperature of the anode track increases from exposure to exposure. The kW values used in the angiographic charts have been determined to prevent damage to the anode. The angiographic rating charts are usable to maximum anode heat content and are based on a starting anode heat content of 70% or less.

Definition of Terms

Number of Exposures in Series: The number of exposures made in succession or the number of exposures made during one contrast injection.

Exposure Rate: The number of exposures made per second. For a series of exposures where the exposure rate changes, it must be assumed that all exposures will be made at the maximum rate. For example, if during a series 10 exposures will occur at one per second and 30 exposures at 4 per second, use the kW ratings in the 40 exposure column at 4 per second rate.

Exposure Time: Time in seconds of Each exposure.

USING THE CHARTS:

Select Correct Chart:

0.3, 0.6 or 1.0 Focal Spot

Note: 150 Hz rotor speed recommended for all angiography.

Determine the number of exposures in Series: With cut film angiography the number of exposures are known, however in Digital Angiography the number of exposures commonly are not known. When determining the number of exposures, assume worst case or past history.

Note: Most angiographic x-ray tubes fail from underestimating the number of exposures made in a series.

Determine kW of each exposure in Series: Referring to chart —find block under “Number of Exposures in Series” that is greater than or equal to expected number of exposures in Series. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select maximum rate per second that will be used for the exposure series. At the intersection of exposure rate and exposure time in seconds, find maximum kW allowed for each exposure.

For Example: 80 pkV and 500 mA = 40 kW

Example: From chart G-2090 150 Hz 3 Phase
 1.0 Focal Spot, determine kW allowed with following known factors.
 Maximum number of exposures40
 Exposure time .050 second (50 milliseconds)
 Maximum Exposure per second4

From chart find 40 exposure block. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select 4 exposures per second. Find .050 seconds at top of chart. At intersection of exposure rate line and exposure time, find 59.5 kW.

0.3 Focal Spot 3Ø 12 Degrees 100 Hz
 0,3 Dimension Focale 3Ø 12 Degrés 100 Hz
 0.3 Brennfleck 3Ø 12 Grad 100 Hz
 0.3 De Marcas Focales 3Ø 12 Grados 100 Hz

Angiographic Ratings IEC 60613
 Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
 Angiographische Nennleistungen IEC 60613
 Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	10.8	10.6	10.5	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	10
2	10.7	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	9.7	9.7	
3	10.7	10.6	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8				
4	10.7	10.6	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8						
8	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	10.1										
15	10.7	10.4	10.2	10.1												
30	10.6	10.3														
1	10.7	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	9.7	9.7	20
2	10.7	10.6	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.7	9.7	9.6	9.5	
3	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.0	9.9	9.8	9.8	9.7	9.6				
4	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8	9.7						
8	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	10.0										
15	10.6	10.4	10.2	10.0												
30	10.5	10.2														
1	10.7	10.6	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.6	9.5	9.4	40
2	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.4	9.3	
3	10.7	10.5	10.4	10.2	10.2	10.1	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4				
4	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	9.7	9.6	9.5						
8	10.7	10.4	10.2	10.1	10.0	9.8										
15	10.6	10.3	10.1	9.9												
30	10.5	10.1														
1	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	60
2	10.7	10.5	10.4	10.2	10.1	10.1	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	
3	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	10.0	9.8	9.7	9.6	9.5	9.3	9.2				
4	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	10.0	9.8	9.6	9.5	9.4						
8	10.7	10.4	10.2	10.0	9.9	9.8										
15	10.6	10.3	10.0	9.8												
30	10.4	10.0														
1	10.7	10.5	10.4	10.2	10.1	10.1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.4	9.3	9.3	9.1	9.0	80
2	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	10.0	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	
3	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.3	9.2	9.1				
4	10.7	10.4	10.3	10.1	10.0	9.9	9.7	9.5	9.4	9.2						
8	10.6	10.4	10.1	10.0	9.8	9.7										
15	10.6	10.2	10.0	9.7												
30	10.4	10.0														
1	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	10.0	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.8	100
2	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.3	9.2	9.1	8.9	8.8	8.7	
3	10.7	10.4	10.3	10.1	10.0	9.9	9.7	9.5	9.4	9.2	9.1	8.9				
4	10.7	10.4	10.2	10.1	9.9	9.8	9.6	9.4	9.3	9.1						
8	10.6	10.3	10.1	9.9	9.8	9.6										
15	10.5	10.2	9.9	9.7												
30	10.4	9.9														
1	10.7	10.4	10.3	10.1	10.0	9.9	9.7	9.5	9.3	9.2	9.0	8.9	8.7	8.6	8.4	150
2	10.7	10.4	10.2	10.1	9.9	9.8	9.6	9.4	9.2	9.0	8.9	8.7	8.6	8.4	8.3	
3	10.7	10.4	10.2	10.0	9.9	9.7	9.5	9.3	9.1	8.9	8.8	8.6				
4	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.7	9.4	9.2	9.0	8.8						
8	10.6	10.3	10.0	9.8	9.6	9.5										
15	10.5	10.1	9.8	9.6												
30	10.3	9.8														

Note:
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
 1. (kW) der Belichtung is gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.3 Focal Spot 3Ø 12 Degrees 150 Hz
 0,3 Dimension Focale 3Ø 12 Degrés 150 Hz
 0.3 Brennfleck 3Ø 12 Grad 150 Hz
 0.3 De Marcas Focales 3Ø 12 Grados 150 Hz

Angiographic Ratings IEC 60613
 Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
 Angiographische Nennleistungen IEC 60613
 Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	12.7	12.5	12.3	12.2	12.1	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.7	11.6	11.5	11.5	11.4	10
2	12.7	12.5	12.3	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.5	11.4	11.3	11.3	
3	12.7	12.5	12.3	12.2	12.1	12.0	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.4				
4	12.7	12.4	12.3	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.5	11.4						
8	12.6	12.4	12.2	12.0	11.9	11.8										
15	12.6	12.3	12.0	11.8												
30	12.5	12.1														
1	12.7	12.5	12.3	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.5	11.4	11.3	11.2	20
2	12.7	12.4	12.3	12.1	12.0	12.0	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11.0	
3	12.7	12.4	12.2	12.1	12.0	11.9	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2				
4	12.7	12.4	12.2	12.1	12.0	11.8	11.7	11.5	11.4	11.3						
8	12.6	12.3	12.1	11.9	11.8	11.6										
15	12.5	12.2	11.9	11.7												
30	12.4	11.9														
1	12.7	12.4	12.3	12.1	12.0	11.9	11.8	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	40
2	12.7	12.4	12.2	12.1	12.0	11.9	11.7	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11.0	10.8	10.7	
3	12.7	12.4	12.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.4	11.3	11.1	11.0	10.9				
4	12.6	12.4	12.2	12.0	11.9	11.7	11.5	11.3	11.2	11.0						
8	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	11.5										
15	12.5	12.1	11.8	11.5												
30	12.3	11.8														
1	12.7	12.4	12.2	12.1	12.0	11.8	11.7	11.5	11.4	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	60
2	12.7	12.4	12.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11.1	11.0	10.8	10.7	10.6	10.4	
3	12.6	12.4	12.1	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	11.1	11.0	10.8	10.7				
4	12.6	12.3	12.1	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8						
8	12.6	12.2	11.9	11.7	11.5	11.4										
15	12.5	12.0	11.7	11.4												
30	12.3	11.7														
1	12.7	12.4	12.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11.1	10.9	10.8	10.7	10.5	10.4	80
2	12.6	12.4	12.1	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.8	10.6	10.5	10.3	10.2	
3	12.6	12.3	12.1	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5				
4	12.6	12.3	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.8	10.6						
8	12.5	12.2	11.9	11.7	11.5	11.3										
15	12.4	12.0	11.6	11.3												
30	12.2	11.6														
1	12.6	12.4	12.1	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.8	10.6	10.5	10.3	10.2	100
2	12.6	12.3	12.1	11.9	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	9.9	
3	12.6	12.3	12.0	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.4	10.3				
4	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	11.5	11.2	10.9	10.7	10.5						
8	12.5	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2										
15	12.4	12.0	11.6	11.3												
30	12.2	11.6														
1	12.6	12.3	12.0	11.8	11.7	11.5	11.2	11.0	10.8	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	150
2	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.9	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	9.4	
3	12.6	12.2	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.8	10.5	10.3	10.0	9.8				
4	12.6	12.2	11.9	11.7	11.5	11.3	10.9	10.6	10.4	10.1						
8	12.5	12.1	11.7	11.4	11.2	11.0										
15	12.4	11.9	11.4	11.1												
30	12.1	11.5														

Note:
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
 1. (kW) der Belichtung is gleich mA x kV Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.6 Focal Spot 3Ø 12 Degrees 100 Hz
 0,6 Dimension Focale 3Ø 12 Degrés 100 Hz
 0.6 Brennfleck 3Ø 12 Grad 100 Hz
 0.6 De Marcas Focales 3Ø 12 Grados 100 Hz

Angiographic Ratings IEC 60613
 Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
 Angiographische Nennleistungen IEC 60613
 Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	33.4	32.6	32.1	31.6	31.2	30.8	30.2	29.6	29.1	28.7	28.3	28.0	27.7	27.3	27.0	10
2	33.4	32.5	31.9	31.4	30.9	30.5	29.8	29.2	28.6	28.1	27.7	27.3	27.0	26.6	26.2	
3	33.3	32.4	31.7	31.2	30.7	30.2	29.4	28.8	28.2	27.6	27.2	26.7	_____	_____	_____	
4	33.2	32.3	31.6	31.0	30.4	30.0	29.1	28.4	27.7	27.2	_____	_____	_____	_____	_____	
8	33.0	31.9	31.0	30.2	29.6	29.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	32.6	31.2	30.1	29.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	32.0	30.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	33.4	32.5	31.9	31.4	30.9	30.5	29.8	29.1	28.6	28.1	27.6	27.2	26.8	26.4	26.0	20
2	33.3	32.4	31.7	31.1	30.6	30.1	29.3	28.6	27.9	27.4	26.9	26.4	26.0	25.5	25.0	
3	33.2	32.2	31.5	30.8	30.3	29.8	28.9	28.1	27.4	26.7	26.2	25.7	_____	_____	_____	
4	33.1	32.1	31.3	30.6	30.0	29.4	28.5	27.6	26.8	26.2	_____	_____	_____	_____	_____	
8	32.8	31.5	30.5	29.7	28.9	28.2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	32.4	30.7	29.4	28.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	31.6	29.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	33.2	32.3	31.6	31.0	30.4	29.9	29.1	28.3	27.6	27.0	26.4	25.9	25.5	24.9	24.4	40
2	33.2	32.1	31.3	30.7	30.1	29.5	28.5	27.7	26.9	26.2	25.6	25.0	24.5	23.9	23.3	
3	33.1	32.0	31.1	30.4	29.7	29.1	28.0	27.1	26.3	25.5	24.9	24.2	_____	_____	_____	
4	33.0	31.8	30.9	30.1	29.4	28.7	27.6	26.6	25.7	24.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	32.6	31.2	30.0	29.0	28.1	27.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	32.1	30.2	28.6	27.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	31.1	28.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	33.1	32.1	31.3	30.6	30.0	29.4	28.4	27.6	26.8	26.1	25.4	24.8	24.3	23.7	23.1	60
2	33.0	31.9	31.0	30.3	29.6	29.0	27.9	26.9	26.0	25.3	24.6	23.9	23.3	22.7	22.0	
3	32.9	31.7	30.8	30.0	29.2	28.6	27.4	26.3	25.4	24.6	23.8	23.1	_____	_____	_____	
4	32.8	31.5	30.5	29.6	28.9	28.1	26.9	25.7	24.8	23.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	32.5	30.9	29.6	28.5	27.5	26.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	31.9	29.8	28.1	26.8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	30.8	28.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	33.0	31.9	31.0	30.3	29.6	29.0	27.9	26.9	26.0	25.2	24.5	23.8	23.2	22.5	21.9	80
2	32.9	31.7	30.8	29.9	29.2	28.5	27.3	26.2	25.3	24.4	23.7	23.0	22.3	21.6	20.9	
3	32.8	31.5	30.5	29.6	28.8	28.1	26.8	25.6	24.6	23.7	22.9	22.2	_____	_____	_____	
4	32.7	31.3	30.2	29.3	28.4	27.6	26.2	25.0	24.0	23.1	_____	_____	_____	_____	_____	
8	32.3	30.6	29.2	28.1	27.0	26.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	31.7	29.5	27.7	26.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	30.5	27.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	32.9	31.7	30.8	29.9	29.2	28.5	27.3	26.2	25.3	24.4	23.7	23.0	22.3	21.6	20.9	100
2	32.8	31.5	30.5	29.6	28.8	28.0	26.7	25.6	24.6	23.7	22.8	22.1	21.4	20.6	19.9	
3	32.7	31.3	30.2	29.2	28.4	27.6	26.2	25.0	23.9	22.9	22.1	21.3	_____	_____	_____	
4	32.6	31.1	29.9	28.9	28.0	27.2	25.7	24.4	23.3	22.3	_____	_____	_____	_____	_____	
8	32.2	30.4	28.9	27.7	26.6	25.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	31.5	29.2	27.4	25.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	30.3	27.2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	32.7	31.3	30.1	29.2	28.3	27.5	26.0	24.8	23.7	22.7	21.8	21.0	20.3	19.4	18.7	150
2	32.6	31.1	29.8	28.8	27.8	27.0	25.5	24.1	23.0	22.0	21.0	20.2	19.5	18.6	17.8	
3	32.5	30.9	29.6	28.4	27.4	26.5	24.9	23.6	22.4	21.3	20.4	19.5	_____	_____	_____	
4	32.4	30.7	29.3	28.1	27.1	26.1	24.4	23.0	21.8	20.7	_____	_____	_____	_____	_____	
8	31.9	29.9	28.3	26.9	25.6	24.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	31.2	28.7	26.7	25.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	29.9	26.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Note:
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.6 Focal Spot 3Ø 12 Degrees 150 Hz
 0,6 Dimension Focale 3Ø 12 Degrés 150 Hz
 0.6 Brennfleck 3Ø 12 Grad 150 Hz
 0.6 De Marcas Focales 3Ø 12 Grados 150 Hz

Angiographic Ratings IEC 60613
 Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
 Angiographische Nennleistungen IEC 60613
 Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	39.4	38.3	37.6	36.9	36.4	35.9	35.0	34.3	33.6	33.1	32.6	32.1	31.7	31.3	30.8	10
2	39.3	38.2	37.3	36.6	36.0	35.5	34.5	33.7	33.0	32.3	31.8	31.2	30.8	30.3	29.8	
3	39.2	38.0	37.1	36.3	35.7	35.1	34.0	33.1	32.3	31.6	31.0	30.5				
4	39.1	37.8	36.9	36.1	35.4	34.7	33.6	32.6	31.8	31.0						
8	38.8	37.3	36.1	35.1	34.2	33.4										
15	38.3	36.3	34.8	33.6												
30	37.5	34.9														
1	39.3	38.1	37.3	36.6	36.0	35.4	34.5	33.6	32.9	32.2	31.6	31.1	30.6	30.0	29.5	20
2	39.2	37.9	37.0	36.3	35.6	34.9	33.8	32.9	32.0	31.3	30.6	30.0	29.5	28.9	28.3	
3	39.1	37.7	36.8	35.9	35.2	34.5	33.3	32.2	31.3	30.5	29.8	29.1				
4	39.0	37.6	36.5	35.6	34.8	34.0	32.7	31.6	30.6	29.8						
8	38.5	36.8	35.5	34.3	33.3	32.4										
15	37.9	35.7	33.9	32.5												
30	36.8	33.8														
1	39.1	37.9	36.9	36.1	35.4	34.7	33.5	32.5	31.6	30.8	30.1	29.4	28.8	28.1	27.5	40
2	39.0	37.6	36.6	35.7	34.9	34.1	32.8	31.7	30.7	29.8	29.0	28.3	27.6	26.9	26.2	
3	38.9	37.4	36.2	35.3	34.4	33.6	32.2	30.9	29.9	28.9	28.1	27.3				
4	38.7	37.2	35.9	34.9	33.9	33.1	31.6	30.2	29.1	28.1						
8	38.3	36.3	34.8	33.4	32.3	31.2										
15	37.5	35.0	33.0	31.3												
30	36.1	32.7														
1	39.0	37.6	36.5	35.6	34.8	34.0	32.7	31.5	30.5	29.6	28.8	28.0	27.3	26.5	25.8	60
2	38.8	37.3	36.2	35.1	34.2	33.4	32.0	30.7	29.6	28.6	27.7	26.9	26.1	25.3	24.5	
3	38.7	37.1	35.8	34.7	33.7	32.9	31.3	29.9	28.7	27.7	26.7	25.9				
4	38.6	36.8	35.5	34.3	33.3	32.3	30.6	29.2	27.9	26.8						
8	38.0	35.9	34.2	32.8	31.5	30.4										
15	37.2	34.5	32.3	30.5												
30	35.7	32.0														
1	38.8	37.3	36.1	35.1	34.2	33.4	31.9	30.6	29.5	28.5	27.6	26.8	26.0	25.2	24.4	80
2	38.7	37.1	35.8	34.7	33.7	32.8	31.2	29.8	28.6	27.5	26.5	25.7	24.9	24.0	23.1	
3	38.5	36.8	35.4	34.2	33.2	32.2	30.5	29.0	27.7	26.6	25.6	24.7				
4	38.4	36.5	35.1	33.8	32.7	31.6	29.8	28.3	27.0	25.8						
8	37.8	35.6	33.8	32.2	30.9	29.7										
15	37.0	34.1	31.8	29.9												
30	35.4	31.5														
1	38.7	37.1	35.8	34.7	33.7	32.8	31.2	29.8	28.6	27.5	26.5	25.7	24.9	23.9	23.1	100
2	38.5	36.8	35.4	34.2	33.1	32.2	30.5	29.0	27.7	26.5	25.5	24.6	23.7	22.8	21.9	
3	38.4	36.5	35.0	33.8	32.6	31.6	29.8	28.2	26.8	25.7	24.6	23.6				
4	38.2	36.3	34.7	33.3	32.1	31.0	29.1	27.5	26.1	24.9						
8	37.7	35.3	33.3	31.7	30.3	29.0										
15	36.8	33.7	31.3	29.4												
30	35.1	31.1														
1	38.4	36.5	34.9	33.6	32.5	31.4	29.6	27.9	26.5	25.3	24.2	23.2	22.4	21.2	19.1	150
2	38.2	36.2	34.6	33.2	31.9	30.8	28.8	27.1	25.7	24.4	23.3	22.3	21.4	20.4	19.1	
3	38.0	35.9	34.2	32.7	31.4	30.2	28.2	26.4	24.9	23.6	22.5	21.4				
4	37.9	35.6	33.8	32.3	30.9	29.7	27.5	25.7	24.2	22.9						
8	37.3	34.6	32.4	30.6	29.1	27.7										
15	36.3	33.0	30.4	28.2												
30	34.6	30.2														

<p>Note: 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.</p>	<p>Remarque: 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.</p>	<p>Anmerkungen: 1. (kW) der Belichtung is gleich mA x kV Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.</p>	<p>Nota: 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.</p>
--	--	--	--

<p>Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613</p>	<p>Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613</p>	<p>Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613</p>	<p>Aproximadamente el poder de penetracion para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613</p>
--	--	--	--

1.0 Focal Spot \varnothing 12 Degrees 100 Hz
 1,0 Dimension Focale \varnothing 12 Degrés 100 Hz
 1.0 Brennfleck \varnothing 12 Grad 100 Hz
 1.0 De Marcas Focales \varnothing 12 Grados 100 Hz

Angiographic Ratings IEC 60613
 Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
 Angiographische Nennleistungen IEC 60613
 Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	63.9	61.9	60.5	59.3	58.2	57.3	55.6	54.2	52.9	51.8	50.7	49.7	48.8	47.7	46.7	10
2	63.7	61.5	59.9	58.5	57.3	56.3	54.4	52.7	51.3	50.0	48.8	47.6	46.6	45.4	44.3	
3	63.5	61.1	59.3	57.8	56.5	55.3	53.2	51.4	49.8	48.4	47.1	45.9				
4	63.3	60.7	58.8	57.1	55.7	54.4	52.1	50.2	48.5	46.9						
8	62.6	59.4	57.0	54.9	53.1	51.4										
15	61.6	57.7	54.6	52.1												
30	60.2	55.2														
1	63.7	61.5	59.8	58.5	57.3	56.2	54.3	52.6	51.1	49.7	48.5	47.3	46.2	45.0	43.8	20
2	63.4	61.0	59.1	57.6	56.2	54.9	52.7	50.8	49.1	47.6	46.2	44.9	43.7	42.3	41.1	
3	63.1	60.5	58.4	56.7	55.2	53.8	51.4	49.3	47.4	45.7	44.2	42.9				
4	62.9	60.0	57.7	55.9	54.2	52.7	50.1	47.8	45.8	44.1						
8	62.0	58.3	55.5	53.1	51.0	49.1										
15	60.6	56.0	52.5	49.5												
30	58.5	52.6														
1	63.3	60.7	58.8	57.1	55.7	54.3	52.0	49.9	48.1	46.5	45.0	43.6	42.3	40.8	39.5	40
2	63.0	60.1	57.9	56.1	54.4	52.9	50.3	48.0	46.0	44.2	42.6	41.1	39.7	38.2	36.8	
3	62.6	59.5	57.1	55.1	53.3	51.6	48.8	46.3	44.2	42.3	40.6	39.0				
4	62.3	59.0	56.4	54.1	52.2	50.4	47.4	44.8	42.5	40.5						
8	61.2	57.0	53.7	51.0	48.6	46.4										
15	59.6	54.3	50.2	46.8												
30	56.9	50.0														
1	62.9	60.0	57.8	55.9	54.2	52.7	50.0	47.7	45.6	43.8	42.1	40.6	39.2	37.6	36.1	60
2	62.6	59.4	56.9	54.8	53.0	51.3	48.3	45.8	43.6	41.6	39.8	38.2	36.7	35.1	33.6	
3	62.2	58.8	56.1	53.8	51.8	49.9	46.8	44.1	41.7	39.7	37.8	36.2				
4	61.9	58.2	55.3	52.8	50.6	48.7	45.3	42.5	40.1	38.0						
8	60.6	56.0	52.5	49.4	46.8	44.5										
15	58.9	53.1	48.6	45.0												
30	55.8	48.4														
1	62.6	59.4	56.9	54.8	52.9	51.2	48.2	45.7	43.4	41.4	39.6	38.0	36.5	34.8	33.3	80
2	62.2	58.7	56.0	53.7	51.6	49.8	46.6	43.8	41.4	39.3	37.5	35.8	34.3	32.6	31.1	
3	61.8	58.1	55.1	52.6	50.4	48.4	45.0	42.1	39.7	37.5	35.6	33.9				
4	61.4	57.4	54.3	51.6	49.3	47.2	43.6	40.6	38.1	35.9						
8	60.2	55.2	51.4	48.2	45.4	43.0										
15	58.3	52.1	47.5	43.7												
30	55.0	47.2														
1	62.2	58.7	56.0	53.7	51.7	49.8	46.6	43.8	41.5	39.3	37.5	35.8	34.2	31.8	28.6	100
2	61.8	58.1	55.1	52.6	50.4	48.4	45.0	42.1	39.6	37.4	35.4	33.7	32.2	30.4	28.6	
3	61.4	57.4	54.2	51.5	49.2	47.1	43.5	40.4	37.9	35.6	33.7	32.0				
4	61.1	56.7	53.4	50.5	48.0	45.8	42.1	39.0	36.4	34.1						
8	59.7	54.5	50.4	47.1	44.2	41.7										
15	57.8	51.3	46.4	42.6												
30	54.4	46.3														
1	61.3	57.2	54.0	51.2	48.8	46.7	43.0	39.9	37.3	34.0	29.8	26.5	23.8	21.2	19.1	150
2	60.9	56.5	53.1	50.1	47.6	45.3	41.5	38.3	35.6	33.3	29.8	26.5	23.8	21.2	19.1	
3	60.5	55.8	52.2	49.1	46.4	44.1	40.1	36.9	34.1	31.8	29.8	26.5				
4	60.1	55.2	51.3	48.1	45.3	42.9	38.8	35.5	32.8	30.5						
8	58.7	52.9	48.4	44.7	41.6	39.0										
15	56.6	49.6	44.4	40.2												
30	53.1	44.4														

<p>Note: 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.</p>	<p>Remarque: 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.</p>	<p>Anmerkungen: 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.</p>	<p>Nota: 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW. 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.</p>
<p>Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613</p>	<p>Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613</p>	<p>Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613</p>	<p>Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613</p>

1.0 Focal Spot 3Ø 12 Degrees 150 Hz
 1,0 Dimension Focale 3Ø 12 Degrés 150 Hz
 1.0 Brennfleck 3Ø 12 Grad 150 Hz
 1.0 De Marcas Focales 3Ø 12 Grados 150 Hz

Angiographic Ratings IEC 60613
 Caractéristiques Pour L'Angiographie CEI 60613
 Angiographische Nennleistungen IEC 60613
 Gradaciones Angiografica IEC 60613

Exposure rate per second	Tube load (kW) as a function of the exposure time (seconds) of the individual radiographs of the series															Number of exposures in series
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	75.1	72.4	70.5	68.9	67.5	66.3	64.1	62.2	60.5	59.0	57.6	56.4	55.2	53.8	52.6	10
2	74.8	71.9	69.7	67.9	66.3	64.9	62.4	60.3	58.4	56.7	55.1	53.7	52.4	50.9	49.5	
3	74.5	71.3	68.9	66.9	65.2	63.6	60.9	58.5	56.5	54.6	53.0	51.5	_____	_____	_____	
4	74.1	70.8	68.2	66.0	64.1	62.4	59.5	57.0	54.8	52.8	_____	_____	_____	_____	_____	
8	73.2	69.0	65.8	63.1	60.7	58.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	71.8	66.7	62.7	59.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	69.9	63.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	74.7	71.8	69.6	67.8	66.2	64.8	62.2	60.1	58.1	56.3	54.7	53.3	51.9	50.3	48.9	20
2	74.4	71.1	68.7	66.6	64.8	63.1	60.3	57.8	55.6	53.6	51.9	50.3	48.8	47.1	45.5	
3	74.0	70.4	67.7	65.4	63.4	61.6	58.5	55.8	53.4	51.3	49.4	47.7	_____	_____	_____	
4	73.6	69.8	66.8	64.3	62.1	60.2	56.8	53.9	51.4	49.2	_____	_____	_____	_____	_____	
8	72.3	67.6	63.8	60.7	58.0	55.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	70.6	64.5	59.8	56.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	67.7	60.0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	74.2	70.8	68.2	66.0	64.1	62.3	59.3	56.6	54.3	52.2	50.3	48.6	47.0	45.2	43.6	40
2	73.7	70.0	67.1	64.6	62.5	60.5	57.1	54.2	51.7	49.4	47.4	45.6	43.9	42.0	40.3	
3	73.3	69.2	66.0	63.3	60.9	58.8	55.2	52.0	49.3	47.0	44.9	43.0	_____	_____	_____	
4	72.8	68.4	65.0	62.1	59.5	57.3	53.4	50.1	47.3	44.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	71.3	65.8	61.5	57.9	54.8	52.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	69.1	62.2	56.9	52.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	65.5	56.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	73.7	69.9	66.9	64.4	62.2	60.2	56.7	53.8	51.1	48.8	46.8	44.9	43.2	41.2	39.5	60
2	73.2	69.0	65.7	63.0	60.5	58.3	54.6	51.3	48.6	46.1	44.0	42.0	40.3	38.3	36.5	
3	72.7	68.2	64.6	61.6	59.0	56.6	52.6	49.2	46.3	43.8	41.6	39.6	_____	_____	_____	
4	72.2	67.3	63.5	60.3	57.5	55.0	50.8	47.3	44.3	41.8	_____	_____	_____	_____	_____	
8	70.6	64.5	59.8	56.0	52.7	49.8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	68.2	60.6	54.9	50.4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	64.1	54.6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	73.2	69.0	65.7	62.9	60.5	58.3	54.5	51.2	48.4	45.9	43.7	41.8	40.0	38.0	35.7	80
2	72.7	68.1	64.5	61.4	58.8	56.4	52.3	48.9	45.9	43.4	41.1	39.1	37.3	35.3	33.5	
3	72.1	67.2	63.3	60.1	57.2	54.7	50.4	46.8	43.8	41.2	38.9	36.9	_____	_____	_____	
4	71.7	66.4	62.2	58.7	55.7	53.1	48.6	45.0	41.9	39.2	_____	_____	_____	_____	_____	
8	69.9	63.4	58.5	54.4	50.9	47.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	67.4	59.4	53.4	48.7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	63.1	53.1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	72.7	68.1	64.5	61.5	58.8	56.5	52.4	48.9	46.0	43.4	41.1	39.1	35.7	31.8	28.6	100
2	72.2	67.2	63.3	60.0	57.2	54.6	50.3	46.7	43.6	41.0	38.7	36.7	34.8	31.8	28.6	
3	71.6	66.3	62.1	58.6	55.6	53.0	48.4	44.7	41.6	38.9	36.6	34.6	_____	_____	_____	
4	71.1	65.4	61.0	57.3	54.2	51.4	46.7	42.9	39.8	37.1	_____	_____	_____	_____	_____	
8	69.3	62.5	57.2	53.0	49.4	46.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	66.7	58.3	52.1	47.3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	62.2	51.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
1	71.5	66.1	61.9	58.3	55.2	52.5	47.9	44.1	39.7	34.0	29.8	26.5	23.8	21.2	19.1	150
2	71.0	65.2	60.6	56.9	53.6	50.8	46.0	42.1	38.9	34.0	29.8	26.5	23.8	21.2	19.1	
3	70.4	64.3	59.5	55.5	52.1	49.2	44.3	40.4	37.1	34.0	29.8	26.5	_____	_____	_____	
4	69.9	63.4	58.4	54.2	50.7	47.7	42.8	38.8	35.6	32.9	_____	_____	_____	_____	_____	
8	68.0	60.4	54.6	50.0	46.2	42.9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
15	65.2	56.1	49.5	44.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
30	60.5	49.5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Note:
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
 1. (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Les expositions inférieures à 0.010 sec. ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613


Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

Stator - Wiring Diagram
 Stator - Schéma de Câblage
 Stator - Drahtfarbentabelle
 Bovina - Diagramas

Stator Ratings and Characteristics
 Spécificités et Caractéristiques du Stator
 Statornennleistungen und Merkmale
 Características y Clarificación de la Bovina

**X-Ray Tube
 Tube á Rayos
 Röntgenröhre
 Tubos de Rayos - X**

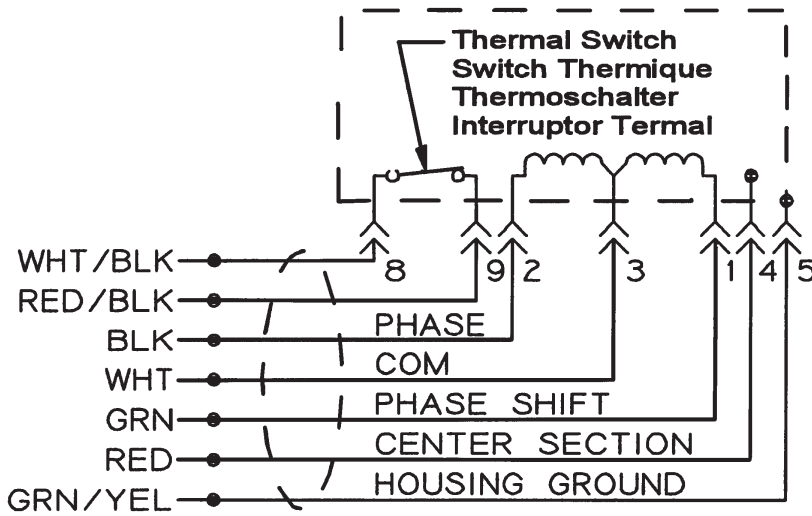

Wire Color Couleurs des Branchements Kabekfarben Cable de Color	Description Description Beschreibung Descripción
1 Green Vert Grün Verde	Phase Shift Stator de Changement de Phase Veränderliche Statorphase Cambio de Fase del Estator
2 Black Noir Schwarz Negro	Phase Phase Phase Fase
3 White Blanc Weiss Blanco	Common Neutre Neutral Común
4 Red Rouge Rot Rojo	Center Section Section Centrale Mittelteil Sección Central
5 Green/Yellow Vert/Jaune Grün/Gelb Verde/Amarillo	Housing Ground Masse de la Gaine Masse des Gehäuses Encaje a Tierra
8 White/Black Blanc/Noir Weiss/Schwarz Blanco/Negro	Thermal Switch Switch Thermique Thermoschalter Interruptor Termal
9 Red/Black Rouge/Noir Rot/Schwarz Rojo/Negro	Thermal Switch Switch Thermique Thermoschalter Interruptor Termal

"R" Stators	Stator "R"	"R" Stator	"R" Bovina	
Black - White	Noir - Blanc	Schwarz - Weiss	Negro - Blanco	14 Ω
Green - White	Vert - Blanc	Grün - Weiss	Verde - Blanco	43 Ω
180 Hz Cap	180 Hz Cap	180 Hz Cap	180 Hz Cap	6 µF
60 Hz Cap	60 Hz Cap	60 Hz Cap	60 Hz Cap	30 µF

Stator Power:
 Time to full speed of the anode is a function of the power rating of the "starter" and the weight / diameter of the anode. All Varex Imaging stator types are rated for regular speed and high speed starters.
 Immediately following high speed anode rotation, the rotor speed must be reduced to 4000 r/min or less within 10 seconds using a suitable dynamic braking device.
 No more than two high speed starts per minute are permissible. The starting voltage must never exceed 600 volts rms.

Puissance du stator:
 Le temps nécessaire à la montée en pleine vitesse est fonction de la puissance du démarreur et du poids/ diamètre de l'anode. Tous les stators Varex Imaging sont prévus pour une vitesse normale et pour une vitesse rapide.
 Immédiatement après la rotation à 4000 t/min ou moins en 10 secondes en utilisant un système de freinage dynamique approprié.
 Pas plus de deux démarrages rapides par minute sont autorisés. La tension de démarrage ne doit jamais excéder 600 volts rms.

Statorleistung:
 Die Zeitspanne bis zur vollen Geschwindigkeit des Anodentellers ist eine funktion aus der Nennleistung des Anlaufgerätes und Gewichtes bzw. Durchmessers des Tellers. Alle Varex Imaging stator sind für hoch- und normaltourigen Betrieb ausgelegt.
 Unter Verwendung einer geeigneten Anogenbremse muß die Drehzahl nach hochtourigem Betrieb unmittelbar auf weniger als 4,000 U/min verreduziert werden. Es sind nicht mehr als zwei Hochleistungsstarts pro minute zulässig. Die Anlaufspannung darf hiebei 600 volt nicht überschreiten.

Poder de la Bovina:
 La velocidad maxima del anodo giratorio es obtenida por el poder del arrancador y es relacionado con el peso y diametro del anodo. Todos las bovinas de Varex Imaging son usadas con velocidad regular y velocidad alta al principio.
 Inmediatamente despues de obtener la velocidad alta del anodo giratorio, la velocidad del rotador debe der reducida a 4000 r/min ó menos en 10 segundos usado un sistema dunamico y apropiado para reducir la velocidad.
 El rotador no debe ser expuesto a velocidades altas no mas de dos (2) veces por minuto. El voltaje inicial no debe excedir 600 voltios rms.

B-240H Housing

Le Gaine B-240H

Das B-240H Gehäuse

Encaje de B-240H


Maximum Peak Voltage	125 kV
Anode to Ground	63 kV
Cathode to Ground	63 kV
Maximum X-ray Tube Assembly Heat Content	1,500 kJ (2.0 MHU)
Maximum Continuous Heat Dissipation (Includes stator heat)	Refer to Heat Exchanger Brochure
Focal Point Position (Central Ray) (X,Y Direction from the center of radiation port.)	Within 1mm
X-Ray Tube Assembly Permanent Filtration	1.0 mm Al IEC 60522
Loading Factors for Leakage Radiation	125 kV, 30 mA
High Voltage Cable Receptacles	Per IEC 60526
Ambient Air Temperature Limits for Operation	5°C to 40°C
Temperature Limits for Storage and Transport	-20°C to +75°C
Humidity	+10% to +90%
Atmospheric Pressure Range	70 kPa to 106 kPa
Weight: Housing	34 kg (74.9 lbs)
IEC Classification	Class I
Safety Devices: Thermal Switch Normally Closed Contact	Opening at 85°C Closes at 74°C
Filament Frequency Limits	50 HZ - 25 KHZ

Maximale Spannungsfestigkeit	125 kV
Anode gegen Erde	63 kV
Kathode gegen Erde	63 kV
Maximale Wärmespeicherkapazität des Strahlergehäuses	1,500 kJ (2.0 MHU)
Maximale kontinuierliche Wärmeableitung des Strahlergehäuses (einschliesslich Statorerwärmung)	Siehe Wärmeaustauscherbrochure
Brennfleckposition (Zentralstrahl) innerhalb von 1mm (X-,Y-Achse von der Mitte des Strahlenaustrittsfensters)	
Röntgenstrahlers Eigenfilterwert	1.0 mm Al IEC 60522
Ladefaktoren für Leckstrahlungsmessung	125 kV, 30 mA
Hochspannungskabelbehälter	Pro IEC 60526
Umgebungstemperaturgrenzen für den Betrieb	5°C zu 40°C
Temperaturgrenzen für Aufbewahrung und Transport	-20°C zu +75°C
Feuchtigkeit	+10% zu +90%
Luftdruck	70 kPa zu 106 kPa
Gewicht - Gehäuse	34 kg (74.9 lbs)
IEC Klassifizierung	Klasse I
Sicherheitseinrichtungen - Thermoschalter normalerweise geschlossen Verbindung	Offen bei 85°C Geschlossen bei 74°C
Heizfaden - Frequenzgrenze	50 HZ - 25 KHZ

Tension maximale	125 kV
Tension Anode - Terre	63 kV
Tension Cathode - Terre	63 kV
Capacité Thermique Maximale de L'Ensemble Tube/Gaine	1,500 kJ (2,0 MUC)
Dissipation thermique continue de la gaine (Inclut la chaleur statorique)	.. Référez-vous à la brochure d'échangeur de chaleur
Position du foyer (rayon central) à 1mm près (Coordonnées X,Y par rapport au centre du port de rayonnement.)	
Ensemble Radiogène Filtre non amovible	1,0 mm Al CEI 60522
Facteur de Charge Poru Rayonnement de fuite	125 kV, 30 mA
Receptacle de câble à haute tension	Par CEI 60526
Température Ambiante Pendant L'usage	5°C à 40°C
Limites de Température Pour le Transport et Pour L'Emmassinage	20°C à +75°C
Humidité	+10% à +90%
Limites de pression atmosphérique	70 kPa à 106 kPa
Poids: Gaine	34 kg (74.9 lbs)
Classification CEI	Classe I
Dispositifs de Sécurité Thermique Normalement Fermé	Ouverture à 85°C Fermeture à 74°C
Limites de fréquence des filaments	50 HZ - 25 KHZ







Tensión máxima	125 kV
Anodo a Tierra	63 kV
Catodo a Tierra	63 kV
Maximo Calor Contenido de Ensamblaje del Tubo de Rayos X	1,500 kJ (2.0 MHU)
Difusion del calor continuo del encaje (Incluye el calor de la bovina)	Refierase al folleto del radiador
Posición de la marca focal (Rayo Central) Dentro de 1mm. (La dirección axial X,Y se refiere del centro de la radiación Portal.)	
Ensamblaje de Tubo de Rayos X Filtracion Permanente	1.0 mm Al IEC 60522
Especificaciones de Encaje para la fuga de Radiación	125 kV, 30 mA
Receptáculo del cable de tensión	Por IEC 60526
Temperatura Limitada de Operación	5°C a 40°C
Temperatura Limitada de Almacen y Transporte	20°C a +75°C
Humedad	+10% a +90%
Límites de la presión atmosférica	70 kPa a 106 kPa
Peso: Encaje	34 kg (74.9 lbs)
IEC Clasificación	Clase I
Aparatos de Seguridad: Interruptor Termal Normalmente Cerrado	Abierto a 85°C Cerrado a 74°C
Limites de la frecuencia del filamento	50 HZ - 25 KHZ

B-240H Housing
 Le Gaine B-240H
 Das B-240H Gehäuse
 Encaje de B-240H




Dimensions are for reference only
 Les dimensions sont pour la référence seulement
 Maße sind als nur Referenz
 Las dimensiones están para la referencia solamente

Note: Dimensions in Inches
Remarque: Dimensions en Pouces
Hinweis: Abmessungen in Zoll
Nota: Dimensiones en Pulgadas



ANODE HEATING AND COOLING CURVES



<p>Note: 1. Heating and cooling curves reflect maximum tube performance. Tube operation is ultimately limited by system software control.</p>	<p>Remarque: 1. Les abaques d'échauffement et de refroidissement représentent des valeurs maximales. L'utilisation du tube est finalement limitée par le logiciel du système.</p>	<p>Anmerkungen: 1. Die Angaben stellen die höchstzulässigen Betriebswerte dar. Der technische Betrieb muß im Rahmen der Belastungs- und Abkühlkennlinien durchgeführt werden.</p>	<p>Nota: 1. El máximo poder del tubo es reflectada en el diagrama de enfriamiento y calentamiento del encaje ensamblado. La operación del tubo es ultimamente limitada por el control del sistema programado.</p>
---	---	---	---